



### 可動床イメージ図

① 最深に設定した場合

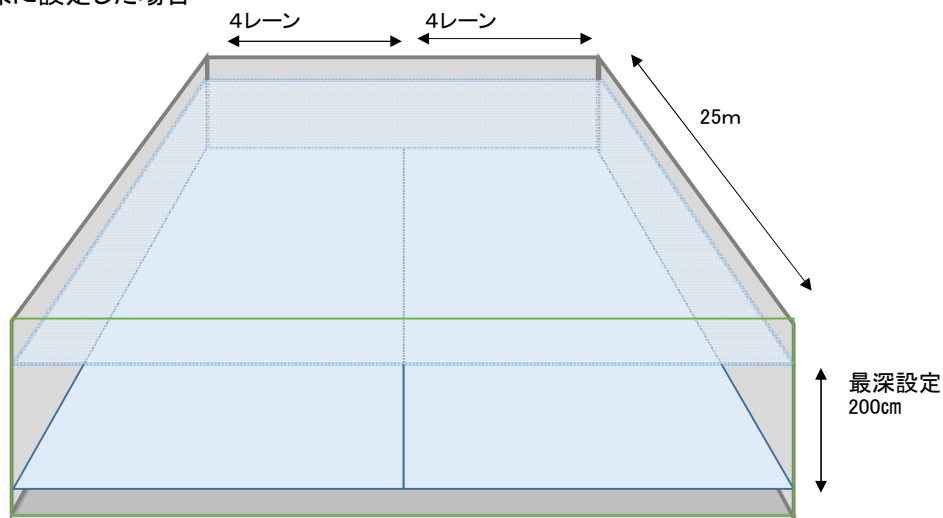

② 水深を変更する場合

- ※片面ずつ水深を変更できる(10cmずつ任意で設定できる)
- ※上下動作は1分間で10cm程度の短時間で変更できる
- ※片面水中歩行用、片面幼児用などとして利用できる

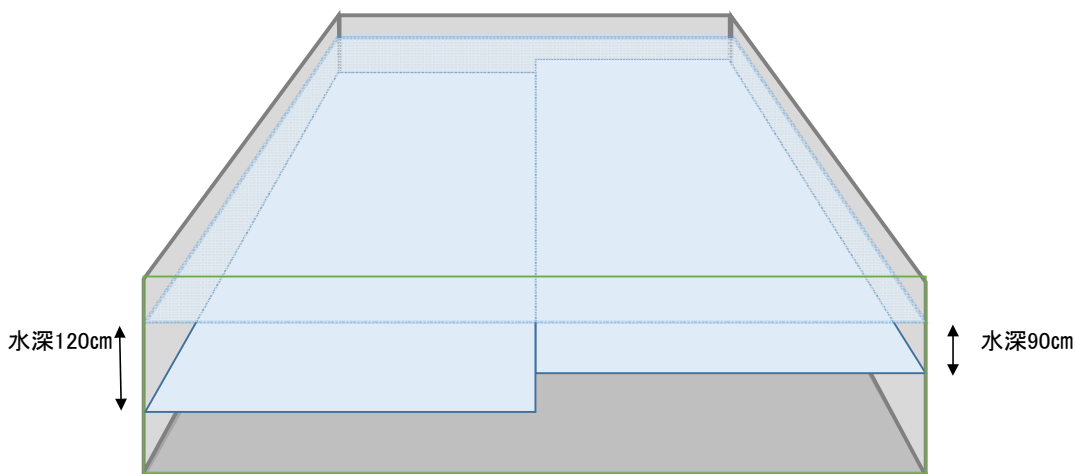

③ 可動床を水面(0cm)まで上げ、保温用のフタとして利用

- ※可動床設置施設においては毎日水面まで上げてフタとして利用している

